
1 Installate il driver USB e il Software Track-It™

IMPORTANTE! NON inserite il Datalogger Track-It™ nella porta USB fino al momento in cui AVRETE installato i Driver USB e il Software Track-It™.

Scaricate il Software Datalogger Track-It™ da:
http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It_Software.zip

Unzippate il file scaricato in una cartella locale del vostro PC.

Doppio clic su **"CD_Start.exe"**. Questo lancerà i Datalogger Track-It™ Data Schermata d'apertura mostrata qui a destra.



1. Cliccate **"Installa il Driver USB"** e seguite le indicazioni. Cliccate "**Continua Comunque**" se vedete quel messaggio durante l'installazione del software.
2. Cliccate su **"Installa Software"** e seguite le istruzioni per completare l'installazione. Il Software è adesso installato e pronto ad essere adoperato.
3. Anche i Logger e i manuali del Software possono essere acceduti qui

2 Installate la batteria del data logger (se occorre)


Installate la batteria che è stata fornita con il vostro datalogger Track-It™. Riferitevi ai diagrammi qui sotto per l'installazione. ***Certi modelli avranno la batteria preinstallata.***

Rimuovete il tappo filettato con una moneta e inserite la batteria come mostrato




Compatto Temp
3.6V 1/2AA Litio
Alta Temperature

Rimuovete il tappo filettato e inserite la batteria come in figura



Pressure/Temp
3.6V 1/2AA

Le Batterie nei logger del tipo "Thumb Drive" sono già installate




Temp, RHTemp, DC I/V, AC Event, Baro/Temp
3V batteria a bottone
CR2032 O 3.6V
EF651625 (LTC-7PN)

3 Collegate il datalogger e lanciate il Sw Track-It™

Inserite il logger Track-It™ in una porta USB disponibile sul PC. Alcuni modelli vanno inseriti direttamente nella porta USB altri si collegano alla porta USB con un cavo (che viene fornito). Se Compare il Wizard Trovato Nuovo Hardware, seguite le indicazioni per concludere l'installazione.


Lanciate il Software Track-It™ con doppio clic sull'icona Track-It™ (mostrata a destra) del vostro PC o dal Menu Avvio.



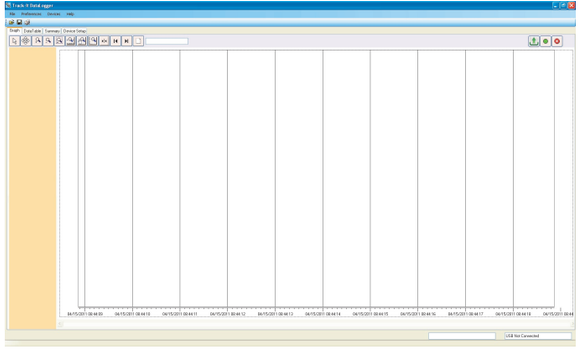


4 Collegarvi al vostro datalogger


Se i driver USB sono installati correttamente vedrete "Device Connected" visualizzato nell'angolo inferiore destro della finestra del Software Track-It™.



Adesso potete iniziare ad adoperare il Software Track-It™ per configurare il vostro datalogger e/o visualizzare i dati registrati.


Il Software Track-It™ elencherà tutti i Datalogger Track-It™ collegati al vostro PC. Per visualizzare l'elenco e alternare tra i vari logger cliccate su Devices quindi Elenco Device.





5 Configurare e avviare la registrazione dati

Scegliere, come in figura, la scheda "**Device Setup**". Il software rintraccerà in modo automatico e visualizzerà la configurazione del datalogger.

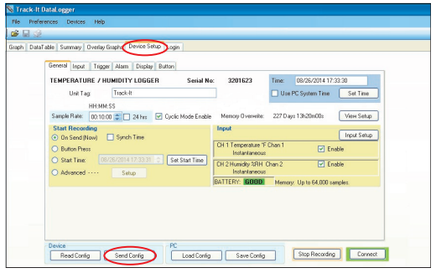


Esaminate le impostazioni di configurazione predefinite di fabbrica ed effettuate le modifiche necessarie – frequenza campioni, trigger, allarmi ecc. Accertatevi che data e ora siano correttamente impostate.
Cliccate il pulsante "**Send Config**" nella sezione della finestra Device Configuration s. **Il vostro datalogger adesso è operativo!**


MONARCH INSTRUMENT
15 Columbia Drive
Amherst, NH 03031
Ph: 603-883-3390
www.monarchinstrument.com

I DISPLAY LCD e gli INDICATORI A LED

Alcuni datalogger Track-It™ sono forniti di display LCD. Il display è programmabile dall'utente e può visualizzare informazioni real time ivi comprese ora, data, valori misurati con unità ingegneristiche, livello della batteria, condizioni di allarme, ecc. Indicatori a LED sugli apparecchi con display LCD sono ugualmente programmabili dall'utente. Si veda il manuale operativo per la descrizione operativa e le istruzioni di configurazione.



Display per logger di Temp, Temp/Humid, AC/Event e DC Voltage/Current.



Display per logger Barometrico/Temp.

Indicatori Icone LCD

Freccia in Alto = Allarme Alto, Freccia in Basso = Allarme Basso. Lampeggia se è in corso un allarme qualsiasi. Acceso fisso se è stato individuato un allarme, ma non è più attuale.

Campanello Acceso Fisso = allarmi abilitati. Lampeggia in caso di allarmi.

Stato della Batteria: Indica piena, mezza e scarica. Lampeggiante = troppo bassa per funzionare in modo affidabile.

REC Accesa Fissa = Innescata per registrare, ma non sta registrando. Lampeggiante = dati in corso di registrazione

Campanello con freccia in alto (Allarme Alto) o freccia in basso (Allarme Basso). Acceso fisso se gli allarmi sono abilitati. Lampeggia se si è verificato un allarme alto/basso ed è attualmente in corso.

Indicatori LED

Gli Indicatori LED sono forniti per avvisare l'utente dello status del datalogger. Premendo e rilasciando il pulsante sul data logger farà in modo che il LED lampeggi secondo vari schemi per indicare lo status. Premendo e mantenendo premuto il pulsante del datalogger cambierà la modalità di registrazione o resetterà gli allarmi (queste funzionalità devono essere configurate nel software prima di poter essere usate). Si veda il manuale operativo per una descrizione completa.

Track-It™ Data Loggers



GUIDA RAPIDA DI AVVIO

Para la traducción española, ver CD
Für die deutsche Übersetzung, siehe CD
Pour la traduction française, voir le CD
Per la traduzione italiana, vedi CD